

# 試料到着時の入力方法について


1. 大分県医師会ホームページの『精度管理』、または大分県臨床検査技師会ホームページの『精度管理事業』、日本臨床衛生検査技師会ホームページの『臨床検査精度管理調査』から『JAMTQC 参加施設向けシステム』をひらく。




2. 画面右側の回答入力メニューをクリックする。

文書	掲載日	内容
	平成29年5月31日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨床検査精度管理調査 微生物菌名マスタの修正について』 微生物菌名マスタの記載に誤りがありましたので、「3. 微生物菌名マスタ」を差し替えます。 最新版は5月31日より手引書でご覧いただけます。 ご迷惑をおかけしまして、申し訳ありません。
	平成29年5月30日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨床検査精度管理調査 試料の発送について』 本日5月30日(火)、この調査の試料を日本通運で発送しました。 各施設への到着は、明日5月31日(水)からとなります。 回答締切日は6月20日(火)午後6時です。期限内に回答ください。 <b>※ 回答画面閉鎖後の入力内容の変更、削除、新規入力等は一切お受けできません。</b>
	平成29年5月26日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨床検査精度管理調査 回答画面について』 『試料到着確認』と『参加項目設定』を行わないと、『回答入力』で回答画面が表示されません。 JAMTQCにログイン → 『回答入力メニュー』 → 『試料到着確認』 → 『参加項目設定』 → 『回答入力』の流れで行ってください。 なお、試料を使用しない検査は『試料到着確認』が不要で、『参加項目設定』のみ必要です。 平成29年度 日臨床検査精度管理調査では、細胞検査、生理検査、病理検査の3つが試料到着確認不要です。
	平成29年5月24日 <small>NEW!</small>	『平成29年度 日臨床検査精度管理調査 手引書、フォトサーベイ集の掲載』 平成29年度 日臨床検査精度管理調査 手引書、フォトサーベイ集を掲載しました。 データ分析メニュー → 平成29年度 日臨床検査精度管理調査 → 手引書 画面でご覧ください。 尚、フォトサーベイはCD等のメディアでの配布はありませのでご注意ください。

3. 『令和 5 年度大分県臨床検査精度管理調査』を選択して、『試料到着確認・参加項目設定』をクリックする。

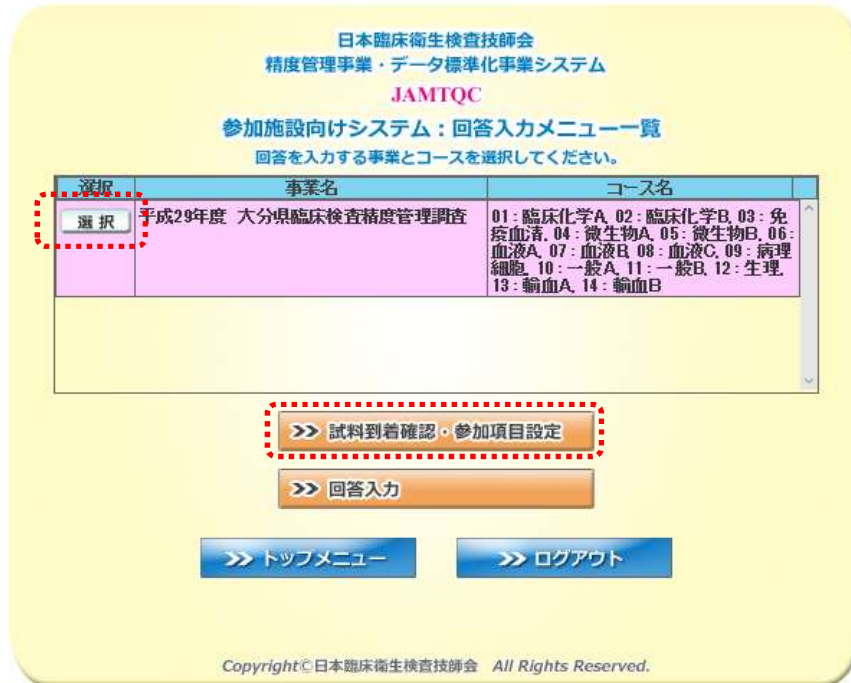

4. 『試料到着確認』画面で、『到着済』にチェックを入れた後、保存する

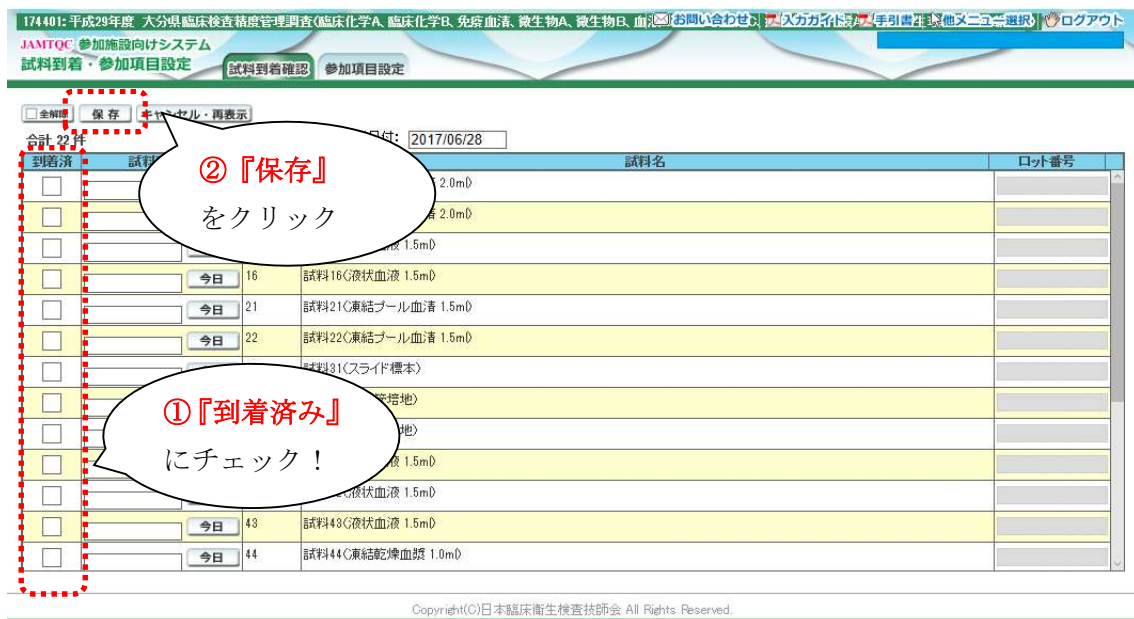

5. 『参加項目設定』タブをクリックして、参加する項目にチェックを入れて保存する。

①『参加項目設定』  
タブをクリック

②『参加する項目』  
にチェック！

③『保存』  
をクリック

参加	評価	コード	項目名
<input type="checkbox"/>	有	101	
<input type="checkbox"/>	有	102	
<input type="checkbox"/>	有	104	
<input type="checkbox"/>	有	105	カリウム
<input type="checkbox"/>	有	106	クロール
<input type="checkbox"/>	有	107	カルシウム
<input type="checkbox"/>	有	108	無機リン
<input type="checkbox"/>	有	109	
<input type="checkbox"/>	有	110	
<input type="checkbox"/>	有	111	
<input type="checkbox"/>	有	112	
<input type="checkbox"/>	有	113	尿酸
<input type="checkbox"/>	有	114	尿酸
<input type="checkbox"/>	有	115	クレアチニン
<input type="checkbox"/>	有	116	総コレステロール
<input type="checkbox"/>	有	117	中性脂肪

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

《以上の操作を必ず行ってください》