


# 試料到着時の入力方法について

1. 大分県医師会ホームページの『精度管理』、または大分県臨床検査技師会ホームページの『精度管理事業』、日本臨床衛生検査技師会ホームページの『臨床検査精度管理調査』から『JAMTQC 参加施設向けシステム』をひらく。



2. 画面右側の回答入力メニューをクリックする。

3. 『令和6年度大分県臨床検査精度管理調査』を選択して、『試料到着確認・参加項目設定』をクリックする。

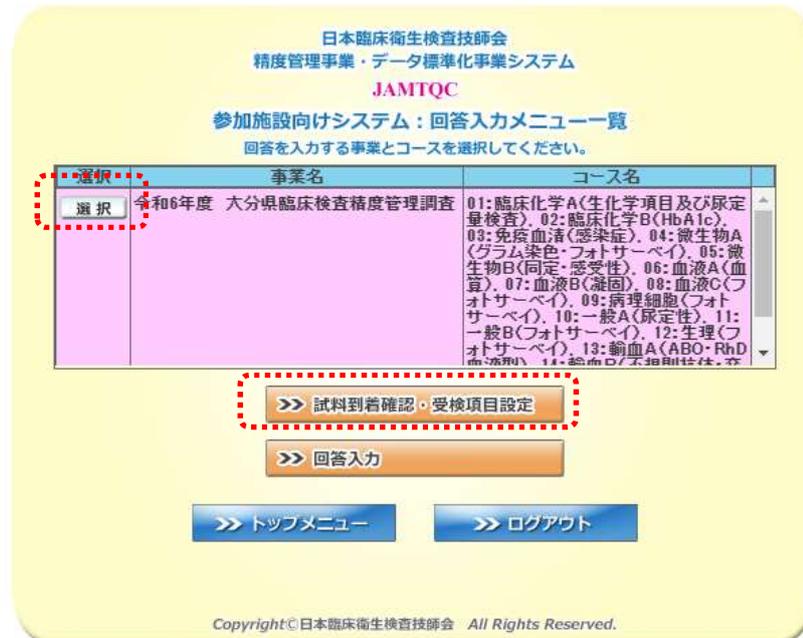

4. 『試料到着確認』画面で、『到着済』にチェックを入れた後、保存する



5. 『参加項目設定』タブをクリックして、参加する項目にチェックを入れて保存する。

244401:令和6年度 大分県臨床検査精度管理調査(臨床化学A、臨床化学B、免疫血清、[お問い合わせ](#)、[入力が不明な項目](#)、[検査項目一括選択](#)、[ログアウト](#)  
輸血A、輸血B、遺伝子) 9940062:一般社団法人 大分県医師会(地域保健課)

①『参加項目設定』  
タブをクリック

②『参加する項目』  
にチェック!

③『保存』  
をクリック

参加	評価	コード	項目名
<input type="checkbox"/>	有	101	
<input type="checkbox"/>	有	102	
<input type="checkbox"/>	有	104	
<input type="checkbox"/>	有	105	カルシウム
<input type="checkbox"/>	有	106	クロール
<input type="checkbox"/>	有	107	カルシウム
<input type="checkbox"/>	有	108	無機リン
<input type="checkbox"/>	有	109	
<input type="checkbox"/>	有	110	
<input type="checkbox"/>	有	111	
<input type="checkbox"/>	有	112	
<input type="checkbox"/>	有	113	
<input type="checkbox"/>	有	114	尿素窒素
<input type="checkbox"/>	有	115	クレアチニン
<input type="checkbox"/>	有	116	総コレステロール

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

《以上の操作を必ず行ってください》